

Dr. Brown's Natural Flow® Baby Bottle

CLEANING

Wash all parts prior to use. The cleaning of the two (2) additional vent assembly parts will require an extra moment. This is time well spent to help avoid spit-ups and other discomforts to your baby.

1. Always use clean hands and surfaces.
2. Fully disassemble all parts.
3. Silicone nipple - first use only: boil the nipple in water for three (3) minutes.
4. Wash all parts thoroughly in hot water and detergent. Use enclosed brush on all holes in the insert and reservoir.
5. Rinse parts thoroughly, making sure that the nipple hole is clean and clear.
6. If you use a dishwasher, keep all parts in the top rack only. Do not exceed 140°F(60°C) water temperature.

ASSEMBLY and FEEDING INSTRUCTIONS

(Please refer to diagram)

NOTE: The bottle WILL NOT FUNCTION without the INSERT and RESERVOIR

1. **Avoid formula bubbles: Do not shake the bottle. Formula should be stirred gently to fully dissolve lumps - they can clog nipple holes.**
2. Fill to the desired amount. The vent will not work properly if you fill the bottle above the FILL LINE WARNING.
3. Snap the reservoir fully onto the insert.
4. Place the reservoir into the bottle, with the insert making full contact with the top of the bottle.
5. Snap the nipple into the nipple collar and place loosely on the bottle.
6. **Warm the bottle - always remove the nipple and collar before warming to**

prevent the vent from leaking fluid if gas forms during warming.

7. **Do not warm the liquid beyond body temperature of 98.6°F(37°C). Always test temperature of liquid before feeding baby.**
8. **Feed – Be sure to ALWAYS tighten the collar firmly before feeding.**

CAUTIONS

1. Due to the risk of creating formula hot spots and overheating, the use of a microwave oven is not recommended. If you use a microwave oven, remember that the nipple and collar must always be removed during heating. Test temperature frequently by placing a few drops on your tongue or back of your hand after stirring thoroughly to eliminate hot and cold spots.
 2. Pull on the nipple before each use to make sure it does not tear. Replace the nipple if it shows any signs of wear, such as cracking or change of shape.
 3. Stop feeding before your baby has completely emptied the nipple to keep your baby from swallowing air that may cause colic or other digestive problems.
 4. Remove the bottle from your baby's mouth when the baby is not feeding. Prolonged contact with milk, formula, and other liquids can cause tooth decay.
 5. The components of this bottle are not toys and should not be given to children to play with or suck on.
 6. Be sure to contact your physician should you have any feeding problems or questions.
- B. When feeding your baby, hold the bottle so that the reservoir tube hole in the bottom of the bottle is not covered by liquid. (Approximately at a 45° angle)
- C. Keep your baby propped up rather than lying down during feeding.
- D. While the vent continuously equalizes pressure, movement of any liquid remaining in the reservoir tube is normal.
- E. If the reservoir bulb remains over 1/3 full when the bottle is placed upright, please check that the nipple hole is clear and that the insert and reservoir are firmly pressed together. The reservoir bulb can be emptied by momentarily loosening the nipple collar. (Be sure to retighten before feeding)
- F. When transporting bottles, always keep them in the upright position.
- G. For proper bottle and venting functions, use only Handi-Craft or Dr. Brown's Natural Flow nipples.

REMINDERS

- A. The nipple included has been specifically selected for an infant's first use of the free-flowing characteristics of the Dr. Brown's Natural Flow® venting system.

Faster flowing Level 2, Level 3 and Y-Cut/Cereal versions of the nipple are available for all Dr. Brown's baby bottles. There is also a slower flow Preemie nipple available for the standard bottle only. If nipples are not available from your retailer, they can be ordered directly from Handi-Craft Company. Nipples of other brands may leak or feed too fast or too slow.

- B. When feeding your baby, hold the bottle so that the reservoir tube hole in the bottom of the bottle is not covered by liquid. (Approximately at a 45° angle)
- C. Keep your baby propped up rather than lying down during feeding.
- D. While the vent continuously equalizes pressure, movement of any liquid remaining in the reservoir tube is normal.
- E. If the reservoir bulb remains over 1/3 full when the bottle is placed upright, please check that the nipple hole is clear and that the insert and reservoir are firmly pressed together. The reservoir bulb can be emptied by momentarily loosening the nipple collar. (Be sure to retighten before feeding)
- F. When transporting bottles, always keep them in the upright position.
- G. For proper bottle and venting functions, use only Handi-Craft or Dr. Brown's Natural Flow nipples.

HANDI-CRAFT® COMPANY
4433 Fyler, St. Louis, MO 63116
www.handi-craft.com
1-800-778-9001

This product is protected by four or more U.S. patents (5,570,796 5,779,071 D420,448 D423,107) and/or national patents, with other U.S. and national patents pending.

LIMPIEZA

Lave todas las piezas antes de usar. La limpieza de dos (2) piezas adicionales de ventilación requerirá unos momentos más. Es tiempo bien utilizado para ayudar a evitar a que el bebé devuelva y que sufra otras incomodidades.

1. Lávese bien las manos y limpie las superficies siempre.
2. Desmonte completamente todas las piezas.
3. Mamila de silicon – primer uso solamente: hierba la mamila en agua durante tres (3) minutos.
4. Lave muy bien todas las piezas con detergente y agua caliente. Use el cepillo incluido en todos los agujeros de la pieza inserta y del depósito.
5. Enjuague muy bien las piezas asegurándose de que el agujero de la mamila esté limpio y despejado.
6. Si usa el lavaplatos, coloque todas las piezas en la rejilla superior solamente. No lave con agua a una temperatura superior de 140° F (60° C).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE y ALIMENTACIÓN

(Por favor consulte el diagrama)

NOTE: El biberón NO FUNCIONARÁ sin la pieza INSERTA y el DEPÓSITO.

1. **Evite la formación de burbujas en la fórmula: No agite el biberón. La fórmula debe menearse suavemente para disolver los terrones, ya que éstos pueden obstruir los agujeros de la mamila.**
2. Llene con la cantidad deseada. La ventilación no funcionará correctamente si llena el biberón por encima de la ADVERTENCIA DE LA LÍNEA DE LLENADO.

3. Coloque a presión el depósito en la pieza inserta.
4. Coloque el depósito en el biberón con la pieza inserta haciendo contacto completo con la parte superior del biberón.
5. Coloque a presión la mamila en el cuello y enrosque al biberón sin apretar.
6. **Caliente el biberón – Quite siempre la mamila y el cuello antes de calentar para evitar que la abertura gotee a causa de la formación de gas durante el calentamiento.**
7. **Caliente el líquido sin rebasar la temperatura corporal de 98.6° F (37° C). Pruebe siempre la temperatura del líquido antes de alimentar al bebé.**
8. **Alimentación – Asegúrese SIEMPRE de apretar firmemente el cuello antes de alimentar al bebé.**

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. No se recomienda el uso del horno de microondas debido al riesgo de crear porciones muy calientes de la fórmula y el sobrecalentamiento. Si usa el horno de microondas, recuerde que siempre debe quitar la mamila y el cuello del biberón antes de calentarlo. Pruebe la temperatura con frecuencia poniendo unas gotas sobre la lengua o en el dorso de la mano después de menear completamente el biberón para eliminar porciones muy calientes.
 2. Estire la mamila antes de cada uso para cerciorarse que no tenga rasgadas. Cambie la mamila si muestra alguna señal de desgaste, como grietas o cambio de la estructura.
 3. Deje de alimentar antes de que el bebé vacíe completamente la mamila para impedir que trague aire y causar cólicos
- u otros problemas digestivos.
4. Retire el biberón de la boca del bebé cuando no se esté alimentando. El contacto prolongado con la leche, la fórmula y otros líquidos puede causar caríes en los dientes.
 5. Los componentes de este biberón no son juguetes y no se debe permitir que los niños jueguen con ellos ni que los mamen.
 6. Comuníquese con su médico en caso de tener alguna pregunta o problema con la alimentación.

RECORDATORIOS

- A. La mamila incluida se ha seleccionado específicamente para el primer uso del bebé, con las características de flujo libre del sistema de ventilación de Natural Flow del Dr. Brown. Se tienen disponibles mamilas en versiones de Nivel 2 y Nivel 3 de flujo más rápido, y de corte en Y para cereal para todos los biberones del Dr. Brown. Hay también disponibles mamilas de flujo más lento para bebés prematuros para el biberón estándar solamente. En caso de que no encuentre mamilas Handi-Craft en su tienda, puede ordenarlas directamente a Handi-Craft Company. Las mamilas de otras marcas pueden gotear o tener un flujo muy lento o muy rápido.
- B. Cuando alimente a su bebé, sujete el biberón de manera que el agujero del tubo del depósito en el fondo del biberón no esté cubierto con líquido (aproximadamente en un ángulo de 45 grados).
- C. Mantenga al bebé semisentado durante la alimentación en lugar de acostarlo completamente.

D. Dado que la abertura equilibra continuamente la presión, el movimiento de cualquier líquido remanente en el tubo del depósito es normal.

E. Si el ensanchamiento del depósito se mantiene 1/3 lleno cuando el biberón está en posición vertical, asegúrese de que el agujero de la mamila esté despejado y que la pieza inserta y el depósito estén firmemente unidos. El ensanchamiento del depósito se puede vaciar aflojando momentáneamente el cuello de la mamila. (Asegúrese de volver a apretar antes alimentar al bebé).

F. Cuando transporte los biberones, manténgalos siempre en posición vertical.

G. Para lograr una función adecuada del biberón y del sistema de ventilación, use sólo mamilas de flujo natural del Dr. Brown™ o Handi-Craft.

HANDI-CRAFT® COMPANY
4433 Fyler, St. Louis, MO 63116
www.handi-craft.com
1-800-778-9001

Este producto está protegido por cuatro o más patentes de EE.UU. [5,570,796 5,779,071 D420,448 D423,107]. y/o patentes nacionales con otras patentes estadounidenses y extranjeras pendientes.

NETTOYAGE

Laver tous les éléments avant utilisation. Le nettoyage de deux (2) éléments supplémentaires de l'évén demande un peu plus de temps. Toutefois, c'est un temps bien employé pour éviter à votre bébé des vomissements et autres désagréments.

1. Vos mains, comme les surfaces utilisées, doivent toujours être propres.
2. Démontez complètement tous les éléments.
3. Tétine en silicone – pour la première utilisation seulement : mettez la tétine pendant trois (3) minutes dans de l'eau en ébullition.
4. Lavez à fond tous les éléments dans de l'eau chaude, avec du détergent. Utilisez la brosse jointe pour frotter tous les trous du raccord et le réservoir.
5. Rincez les différents éléments à fond, puis vérifiez que le trou de la tétine est bien propre et non obstrué.
6. Si vous utilisez un lave-vaisselle, mettez tous les éléments dans le panier supérieur seulement. La température de l'eau ne doit pas dépasser 60 °C (140 °F).

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE et D'ALIMENTATION

(Voir le diagramme)

REMARQUE : Le biberon NE FONCTIONNERA PAS sans le RACCORD et le RÉSERVOIR

1. Évitez les bulles dans le lait maternisé : Ne secouez pas le biberon. Il faut remuer doucement le lait maternisé pour bien dissoudre les grumeaux – sinon, ils risquent de boucher le trou de la tétine.
2. Remplissez avec la quantité voulue.

L'évén ne fonctionnera pas correctement si le biberon est rempli au-dessus de la LIGNE DE REMPLISSAGE MAXIMUM.

3. Insérer complètement le réservoir dans le raccord.
4. Placer le réservoir dans le biberon, le raccord étant complètement en contact avec le dessus du biberon.
5. Emboîtez la tétine dans le porte-tétine et placez-la sur le biberon, sans serrer.
6. **Faites réchauffer le biberon – toujours enlever la tétine et le porte-tétine avant de le faire chauffer pour éviter la fuite de liquide par l'évén au cas où des gaz se forment.**
7. **Ne faites pas chauffer le liquide à une température supérieure à celle du corps (37 °C ou 98,6 °F). Toujours tester la température du liquide avant de donner le biberon au bébé.**
8. **Tétée – faites attention de TOUJOURS serrer fermement le porte-tétine avant de faire téter le nourrisson.**

AVERTISSEMENTS

1. Il n'est pas recommandé d'utiliser un four à micro-ondes en raison des risques de surchauffe ou de parties plus chaudes dans le lait maternisé. Si vous utilisez un four micro-ondes, n'oubliez pas d'enlever la tétine et le porte-tétine lorsque vous faites chauffer le biberon. Testez fréquemment la température en versant quelques gouttes sur votre langue ou le dos de votre main après avoir bien remué le lait pour éliminer les parties chaudes et froides.
2. Tirez sur la tétine avant chaque utilisation pour vérifier qu'elle ne se déchire pas. Si elle montre des signes

d'usure, comme des craquelures ou un changement de forme, remplacez-la.


3. Arrêtez la tétée avant que votre bébé ait vidé entièrement le biberon pour éviter qu'il avale de l'air, ce qui pourrait provoquer des coliques ou d'autres problèmes de digestion.
4. Enlevez le biberon de la bouche de votre bébé lorsqu'il ne tète pas. Un contact prolongé avec le lait, le lait maternisé ou d'autres liquides peut provoquer une carie des dents.
5. Les éléments de ce biberon ne sont pas des jouets et ne doivent pas être donnés aux enfants pour qu'ils jouent avec ou les suçent.
6. Si vous avez des problèmes ou des questions d'alimentation, consultez votre médecin.

RAPPELS

- A. La tétine qui est incluse a été spécifiquement choisie pour les nourrissons qui utilisent pour la première fois les caractéristiques d'écoulement libre du système d'évén Dr. Brown's Natural Flow®. Il existe d'autres sortes de tétines (stade 2, stade 3 et coupe en Y/pour céréales) pour tous les biberons Dr. Brown's. Il existe également une tétine à écoulement plus lent pour les prématurés pour le biberon standard seulement. Si votre détaillant ne vend pas les tétines Handi-Craft, vous pouvez les commander directement auprès de Handi-Craft. Les tétines d'autres marques risquent de fuir ou de couler trop vite ou trop lentement.
- B. Lorsque vous alimentez votre bébé, tenez le biberon de façon à ce que le trou du tube du réservoir, au fond du biberon, ne soit pas recouvert de liquide

(à un angle approximatif de 45 °).

- C. Tenez votre bébé en position verticale plutôt que couché pendant qu'il tète.
- D. Du fait que l'évén égalise continuellement la pression, il est normal que le liquide restant dans le réservoir bouge.
- E. Si la partie bulbeuse du réservoir reste pleine à plus du tiers lorsque le biberon est en position verticale, vérifiez si le trou de la tétine n'est pas obstrué et si le raccord et le réservoir sont bien serrés ensemble. La partie bulbeuse du réservoir peut être vidée en desserrant momentanément le fixe-tétine (Veuillez à bien le resserrer avant la tétée).
- F. Transportez toujours le biberon en position verticale.
- G. Pour que le biberon et le système d'évén fonctionnent bien, utilisez seulement les tétines Dr. Brown's à écoulement naturel ou Handi-Craft.

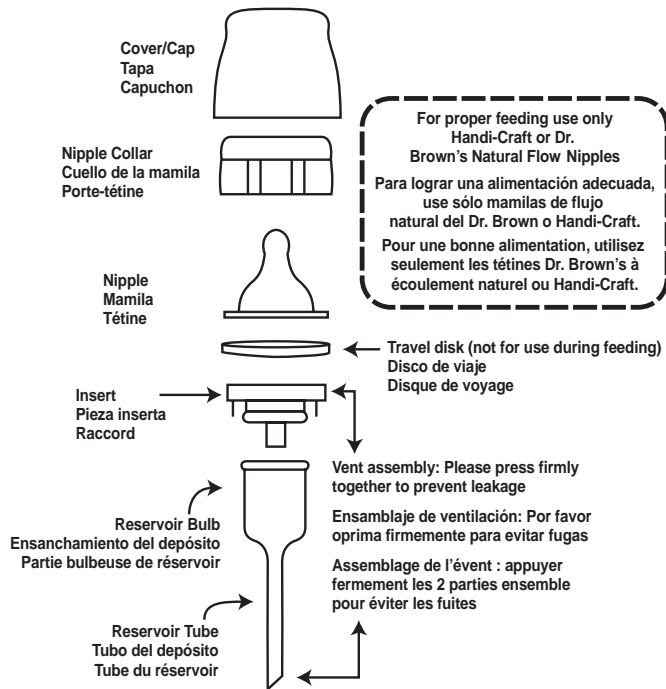

HANDI-CRAFT® COMPANY
4433 Fyler, St. Louis, MO 63116
www.handi-craft.com
1-800-778-9001

Ce produit est protégé par quatre brevets américains ou plus (5,570,796 5,779,071 D420,448 D423,107) Autres brevets nationaux et étrangers en instance.